



Rilevatore pH ExStik™ resistente all'acqua

Modello PH110

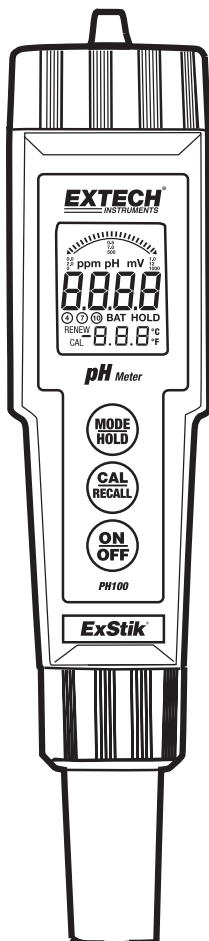


Pannello di controllo frontale

1. Copertura del compartimento batteria
 2. Display LCD
 3. Tasto MODE / HOLD
 4. Tasto CAL / RECALL
 5. Tasto ON/OFF
 6. L'anello dell'Elettrodo
- (la copertura dell'Elettrodo non è mostrata)

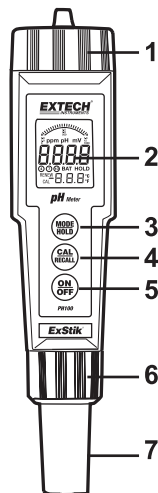

Display

1. Lettura grafico a barra
2. Lettura della misurazione
3. Spie BAT (batteria scarica) e HOLD (data hold)
4. Display della Temperatura
5. Scala del grafico a barra
6. Unità di misura
7. Indicatori di calibratura
8. Spie RENEW e CAL

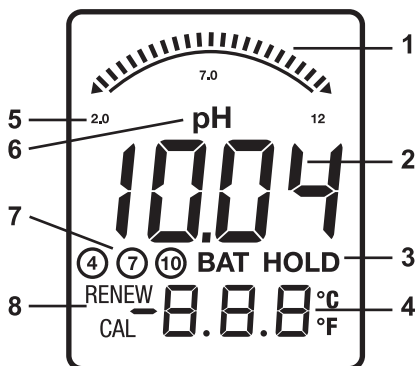

PRECAUZIONI

- Questo dispositivo non è un giocattolo non deve essere maneggiato da bambini. Contiene parti pericolose e piccole che i bambini potrebbero inghiottire. In caso un bambino ne ingoi, contattare immediatamente un medico
- Non lasciare le batterie e il materiale di confezionamento in giro senza supervisione; possono essere pericolosi per i bambini se utilizzati come giocattoli.
- Se il dispositivo non sarà utilizzato per lungo tempo, rimuovere le batterie per evitare che si scarichino
- Batterie scadute o danneggiate possono causare cauterizzazione se entrano in contatto con la pelle. Utilizzare quindi, sempre, dei guanti adeguati
- Controllare che le batterie non siano in corto circuito. Non gettare le batterie nel fuoco.

Sommario

Sommario sul pH

Il pH è un'unità di misura (che varia tra 0 e 14pH) che indica il grado di acidità o alcalinità di una soluzione. I test pH sono quelli più comunemente utilizzati nelle analisi dell'acqua e registrano il log negativo dell'attività ione idrogeno di una soluzione che è un indicatore dell'acidità o alcalinità. Soluzioni con un pH minore di 7 sono considerate acide, soluzioni con un pH superiore a 7 sono chiamate basi, e le soluzioni con un pH di esattamente 7 sono neutrali.

La scala pH è logaritmica, quindi per esempio, se il campione A ha pH di 1 grado inferiore al campione B, ciò significa che il campione A è 10 volte più acido del campione B. Una differenza di 1 grado nella scala pH rappresenta un incremento dell'acidità del campione di 10 volte.

Getting Started

- Per i nuovi rilevatori, rimuovere la copertura della batteria e poi rimuovere la banda isolante della batteria.
- Rimuovere la copertura dal fondo dell'ExStik™ per esporre la superficie di vetro dell'elettrodo e la giunzione di riferimento
- Prima del primo utilizzo e dopo un lungo stoccaggio, immergere l'elettrodo (senza la copertura) in una soluzione pH 4 per circa 10 minuti
- Nella copertura possono essere presenti dei cristalli di cloruro di potassio. Questi cristalli si dissolveranno nella soluzione o altrimenti possono essere rimossi con un risciacquo con della semplice acqua di lavandino
- Calibrare sempre vicino al valore di riferimento atteso
- Prima, è presente una spugna nella copertura dell'elettrodo. Mantenere questa spugna immersa in a una soluzione a pH 4 per preservare la funzionalità dell'elettrodo durante lo stoccaggio

Sostituzione degli elettrodi

L'ExStik™ viene consegnato con un elettrodo già montato. La durata degli elettrodi è limitata e dipende da (tra altri fattori) frequenza d'utilizzo e cura. Se l'elettrodo deve essere sostituito, seguire questi passi per rimuovere e connettere gli elettrodi.

1. Per rimuovere un elettrodo, svitare e rimuovere completamente il collare che blocca l'elettrodo.
2. Scuotere gentilmente l'elettrodo da un lato all'altro, estraendolo dal rilevatore, fino a che sia possibile disconnettere.
3. Per attaccare il nuovo elettrodo, inserire con cura l'elettrodo stesso nella presa del rilevatore (assicurarsi che il connettore dell'elettrodo ben inserito, assicurando una ferma connessione).
4. Assicurare che l'elettrodo sia ben fermo stringendo con decisione l'anello. (una guarnizione di gomma sigilla l'elettrodo con il rilevatore).

Riconoscimento automatico dell'Elettrodo

Quando l'ExStik™ è acceso, riconosce il tipo di elettrodo connesso e visualizza la corretta unità di misura. Attaccare l'elettrodo prima di accendere l'ExStik™.

Alimentare l'ExStik™

Premere il tasto ON/OFF per accendere e spegnere l'ExStik™. La funzione di autospegnimento spegne l'ExStik™ automaticamente dopo 10 minuti di inattività per preservare la durata delle batterie.

Sommario

Quando l'elettrodo è immerso in una soluzione, il display principale e il grafico a barra indicano la lettura pH mentre il display inferiore legge la temperatura (le letture visualizzate lampeggiano fino a quando non si sono stabilizzate). Il grafico a barra 'centrato su zero', quindi con un pH 7 non c'è alcuna visualizzazione. Mentre il pH aumenta, la barra si muove dal centro verso destra. Se il pH scende, la barra si muove dal centro verso sinistra.

Calibratura del pH (1, 2, o 3 punti)

Una calibratura a due punti con una soluzione tampone di di 7 più 4 o 10 (qualunque sia più vicino al valore atteso del campione) è sempre raccomandata. Una calibratura ad un punto (scegliere il valore più vicino al valore atteso del campione) è anche valida. Per la massima precisione, calibrare sempre alla temperatura del campione.

1. Posizionare l'elettrodo in una soluzione campione (4, 7, o 10) e premere brevemente il tasto CAL. pH 7 dovrebbe essere calibrato prima, poi 4 e/o 10 pH.
2. L'ExStik™ riconosce automaticamente la soluzione e si autocalibra su quel valore. Nota: Se la soluzione differisce per più di 1pH dagli standard 4, 7, o 10pH, l'ExStik™ lo riterrà un errore e interromperà la calibratura. Saranno visualizzati CAL e END.
3. Durante la calibratura, la lettura del pH lampeggia sul display.
4. Quando la calibratura è completa, l'ExStik™ mostrerà automaticamente 'END' e ritornerà alla modalità di funzionamento normale.
5. L'adeguato indicatore cerchiato ④, ⑦, o ⑩ apparirà sul display LCD quando una calibratura è stata completata. I dati della calibratura sono conservati fino alla prossima calibratura.
6. Per una calibratura a due o tre punti, ripetere i passi da 1-4.

Nota: Spegner e riattivare sempre il rilevatore prima della calibratura per garantire tempo sufficiente per completare la calibratura in un ciclo batteria. Se il rilevatore si auto spegne durante la calibratura, la calibratura stessa rimane valida, ma nuove calibrature spegneranno gli indicatori cerchiati.

Cambio delle unità di temperatura visualizzate


Tenere premuto il tasto CAL per circa 3 secondi. Le icone °C o °F dopo aver rilasciato i tasti cambieranno prima le icone e poi il valore numerico della temperatura. Se si è entrati erroneamente nella modalità di calibratura apparirà 'CAL' sul display LCD. Spegner e riattivare l' ExStik™ e riattivarlo.

Data Hold

Premere brevemente il tasto MODE per mantenere visualizzata la presente lettura. Sarà visualizzata l'icona HOLD insieme alla lettura stessa. La lettura visualizzata sarà inoltre memorizzata. Premere brevemente il tasto MODE per ritornare alla modalità normale.

15- Memorizzazione delle letture

1. Premere brevemente il tasto MODE per memorizzare una lettura. Il display LCD mostrerà brevemente il numero della posizione in memoria e poi il valore memorizzato (Data Hold sarà attivato).
2. Premere brevemente ancora il tasto MODE per ritornare alla modalità normale.
3. Ripetere il passo 1 per memorizzare la prossima lettura e così in avanti.
4. Dopo che 15 letture sono state memorizzate l'ExStik™ comincerà a sovrascrivere sulle vecchie letture memorizzate, partendo dalla 1 in avanti.

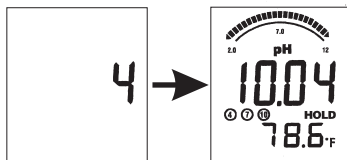

Visualizzare letture memorizzate

Nota: Controllare che il simbolo HOLD non sia visualizzato. Se lo è, uscire dalla funzione HOLD premendo brevemente il tasto MODE.

1. Premere brevemente il tasto CAL e premere poi MODE subito dopo che CAL viene mostrato sul display; la posizione in memoria (da 1 a 15) lampeggerà. Se si è entrati erroneamente in modalità CAL (lampeggia), premere il tasto CAL nuovamente per uscirne.
2. L'ultima lettura memorizzata sarà mostrata per prima. Per scorrere i dati in memoria (le varie letture), premere brevemente il tasto MODE. Il numero della posizione sarà mostrato per primo, seguito poi dalla lettura stessa.
3. Per uscire la modalità di richiamo (delle letture memorizzate), premere brevemente il tasto CAL e l'ExStik™ ritornerà al normale funzionamento.

Visualizzazione promemoria CAL

Quando l'ExStik™ è in modalità pH per la 15ma volta senza ricalibratura, apparirà l'icona 'CAL' sul display LCD indicando che potrebbe essere necessario ricalibrare l'ExStik™. Alcune applicazioni potrebbero richiedere la ricalibratura dell'elettrodo più frequentemente di altre. L'icona CAL è solo un promemoria e scompare quando l'elettrodo pH viene ricalibrato.

Visualizzazione RENEW


L'icona lampeggiante 'RENEW' indica che la sonda potrebbe essere vicina alla fine del suo ciclo di vita utile. Se la pulizia o la ricalibratura non fanno scomparire l'icona RENEW, sostituire l'elettrodo. L'icona RENEW appare quando l'output elettrodo pH fallisce un test diagnostico.

Considerazioni

- Se l'unità appare bloccata (display bloccato) è possibile che sia stata attivata inavvertitamente la modalità Data Hold premendo il tasto MODE. È sufficiente, in questo caso, premere ancora il tasto MODE o riattivare il rilevatore per.
- Se il rilevatore non si riattivasse e nemmeno premendo i tasti non mostrasse segni di vita, rimuovere le batterie, premere il tasto ON per 3 secondi e reinserire le batterie.
- Considerare che rimuovendo le batterie si perdono tutti dati memorizzati nel rilevatore. Compresa la calibratura per il pH impostata. Sarà necessario reimpostare una nuova calibratura. Tutte le impostazioni di fabbrica saranno ovviamente mantenute.

Sostituzione della Batteria

1. Svitare il coperchio del compartimento batteria
2. Sostituire le quattro (4) 2032 batterie rispettando la polarità.
3. Riavvitare il coperchio del compartimento batteria

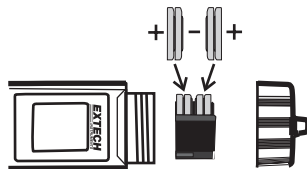

Voi, utenti finali, siete legalmente obbligati (**Ordinanza sulle batterie**) a restituire ai centri di raccolta specializzati tutte le batterie e gli accumulatori usati; **è vietato lo smaltimento con la spazzatura domestica!** Potete consegnare le vostre batterie / accumulatori usati, gratuitamente, ai centri di raccolta specializzati delle nostre agenzie, o dovunque si vendano batterie / accumulatori!

Smaltimento: Seguire le disposizioni di legge riguardo lo smaltimento dei dispositivi al termine del loro vita utile.

Riempimento Elettrodo pH (pH110/115 solo elettrodi riempibili)

L'elettrodo riempibile non deve essere staccato dal corpo del ExStik™ per iniziare la procedura di riempimento. Gli elettrodi riempibili (PH115) hanno un giunto rimovibile di riferimento (a fessura) e la parola REFILLABLE è sul lato dell'involucro dell'elettrodo.



Modulo di
Riempimento pH


Rimuovere il Giunto di Riferimento

L'attrezzo fornito con il Kit di Riempimento PH113 è usato per rimuovere il giunto di riferimento dalla superficie sensibile dell'elettrodo. Se il giunto di riferimento non ha fessure per agganciarvi i 'denti' dell'attrezzo da rimozione, l'elettrodo NON è riempibile.

Tenendo l'elettrodo sotto sopra, svitare e rimuovere il giunto di riferimento usando l'attrezzo per la rimozione.



Attrezzo di Rimozione
Giunto



Giunto di Riferimento

Riempire l'Elettrodo



1. Una volta che il giunto di riferimento è stato rimosso, riempire la cavità con la soluzione di riempimento fornita nel Kit di Riempimento.
2. Rimettere il giunto di riferimento usando l'attrezzo da rimozione/installazione. (Giunti in più sono in dotazione se necessari).

Soluzione di Riempimento

Il contenitore fornito include 15ml di soluzione di riempimento. La soluzione è sufficiente per 4 o 5 riempimenti. Usare solo la soluzione fornita per il riempimento dell'elettrodo.

Specifiche Tecniche

Display	LCD Multifunzione con grafico a barra
Condizioni operative	da 0 a 50°C (da 32 a 122°F) / < 80% RH
Campo di misurazione e precisione	da 0.00 a 14.00 / ± 0.01 pH tipico
Compensazione della Temperatura	Automatico da 0 a 90°C (da 32 a 194°F)
Campo di misurazione della Temperatura	da -5 a 90°C (da 23 a 194°F)
Risoluzione della Temperatura	0.1° fino a 99.9 e 1° oltre
Precisione della Temperatura	$\pm 1^\circ\text{C}/1.8^\circ\text{F}$ [da -5 a 50°C (23 a 122°F)] $\pm 3^\circ\text{C}/5.4^\circ\text{F}$ [da 50 a 90°C (122 a 194°F)]
Conservazione dati	15 letture elencate (numerare)
Alimentazione	Quattro batterie a bottone (4) CR2032
Avviso Batteria scarica	'Appare BAT' sul LCD
Autospegnimento	Dopo 10 minuti d'inattività
Dimensioni	35.6x172.7x40.6mm (1.4x6.8x1.6"); 110g (3.85oz)

Accessori opzionali

- buffer Tripak con capsule pH 4, 7 e 10 (6 ciascuno) e due soluzioni di lavaggio (Part Number: PH103)
- pH 4,01 buffer, pinta, (Codice PH4-P)
- pH 7,00 buffer, pinta, (Codice PH7-P)
- pH 10,00 tampone, pinta, (Codice PH10-P)
- Elettrodo pH di ricambio - non ricaricabili (Part Number: PH105)
- Elettrodo pH di ricambio - ricaricabile (Codice PH115)
- Soluzione di ricarica (Codice PH113)
- elettrodi di ricambio ORP (Part Number: RE305)
- elettrodi di ricambio di cloro (Part Number: CL205)
- Base bilanciata con 5 tazze di soluzione (Codice: EX006)

Nota: Se l'unità deve essere convertito per l'utilizzo di cloro redox o collegando l'elettrodo corretta, si prega di visitare www.extech.com per scaricare la Guida utente corretto

Copyright © 2011 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)
Tutti i diritti riservati, incluso il diritto di riproduzione intera o parziale in qualsiasi forma.
www.extech.com